



暗視野照明装置



写真のように顕微鏡のステージにセットします

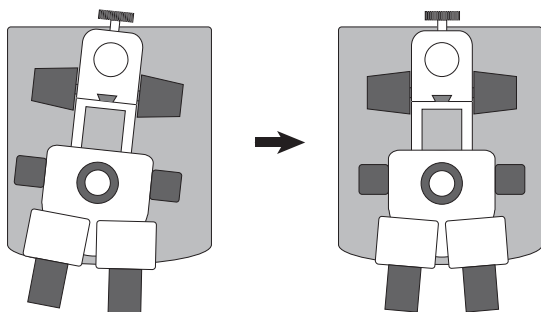

上方からみて顕微鏡の鏡筒が左図のようにずれている場合は、位置を修正します。

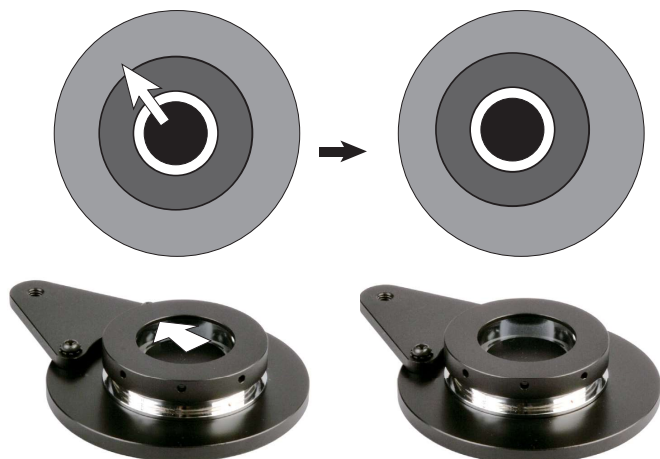

必要に応じて暗視野照明装置の上部の位置をスライドさせて、最適な照明効果が得られるように調整します。